

CRP FUSION • EINFACH ERKLÄRT

Drogen-Schnelltests für Speichel- und Urin-Proben

Die passende Testform finden, richtig anwenden und Ergebnisse verstehen.

Produktbilder: CRP-Katalog 2026. Fotoszenen: illustrative Darstellung.

WEGWEISER DURCH DIE PRODUKTBROSCHÜRE

Inhaltsverzeichnis

EINFACH ZUM PASSENDEN TEST

Von der Auswahl der Speicheltests über Urin-Panels bis zu den Substanzlisten: Die folgenden Seiten führen Schritt für Schritt durch das Sortiment.



01 CRP Fusion | Unternehmen 03

02 Orientierung & Überblick 04–05

03 Speichelprodukte 06–13

SPEICHEL / PRODUKTE & ANWENDUNG

Alkohol-Stift | Fit2Drive 06

THC-Kassette | 3,5 ng/ml 07

8 + 1 Kassette 08

9er-Stift | Industrie 09

1 bis 12 Substanzen 10

Becher | 15 Substanzen 11

Weitere Testprodukte & Ablauf 12

Ergebnis verstehen 13

URIN / SERVICE / ANLAGEN

Urin-Produktbereich 14

Urin-Panel | 9 Substanzen 15

Kontakt & Auswahlhilfe 16

Kundenspezifische ALC-Labels 17

Anlage A | Speichel-Substanzen 18

Anlage B | Urin-Substanzen 19–20

Preisliste | alle Produktgruppen 21

FAQ | Produkte und Services 22–24

CRP Fusion - Kompetenz im Bereich von Drogen-Tests und Services

SEIT 2015 IN BRAȘOV (KRONSTADT)

CRP Fusion SRL wurde 2015 in Brașov gegründet. Das Unternehmen ist exklusiver Partner von RoDiagnostics SRL, einem Hersteller von Speichel- und Urin-Drogentests. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermarktung und dem Vertrieb von Drogentest-Produkten. In Rumänien arbeitet CRP Fusion mit Ropharma S.A. und Dasco Distribution zusammen.

PEDT - PRE-EMPLOYMENT DRUG TESTING

Seit Ende 2025 baut CRP Fusion diesen Dienstleistungsbereich mit der PEDT-Abteilung von Securitas India aus. Im Auftrag von Securitas werden nach Unternehmensangaben United Kingdom, Belgien, Kanada, Mexiko, Malaysia und Argentinien betreut. Für 2026 ist die Erweiterung nach Australien, Südafrika, auf die Philippinen sowie nach Südkorea und China geplant.

PARTNER & KOOPERATIONEN

Securitas India
PEDT-Kooperation

Job Selection
Background Screening

cFIRST
Internationaler Ausbau

2027 | 50–100 KANDIDATEN / MONAT

Ziel ab Anfang 2027

ENDE 2027 | MINDESTENS 200 / MONAT

Geplanter weltweiter Ausbau mit cFIRST, einem Background-Check-Unternehmen mit Büros in Indien, UK und USA

PRODUKTE & ZULASSUNG

Die Produkte sind durch die ANMDMR Rumänien als Selbsttests zertifiziert und zugelassen. Diese Zertifizierung stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Vertrieb im europäischen Markt dar.

Unternehmensangaben und Planungsziele, Stand September 2026.

EINFACHER EINSTIEG

Was wird getestet?

Ein Schnelltest sucht nach einem bestimmten Stoff oder nach mehreren Stoffen gleichzeitig.

SPEICHEL

Eine weiche Sammelspitze nimmt Flüssigkeit aus dem Mund auf. Es gibt einzelne Tests als Stift oder Kassette und Mehrfachtests als Stift, Kassette oder Becher. Das Ergebnis erscheint nach der jeweiligen Anleitung meist in wenigen Minuten.

URIN

Die Probe wird in einem Becher gesammelt. Ein Mehrfachtest kann mehrere Stoffgruppen prüfen. Die genaue Zusammensetzung des Urin-Panels ist für dieses Dokument nicht im vorgelegten Katalog angegeben und muss vor Bestellung bestätigt werden.

WICHTIG ZU WISSEN

Ein Schnelltest ist ein erster Hinweis. Ein auffälliges Ergebnis ist vor weitreichenden Entscheidungen mit einer geeigneten Laboranalyse zu klären.

Sechs Wege zum passenden Speicheltest




Alkohol-Stift

1 Drogen-Substanz




THC-Kassette

1 Drogen-Substanz

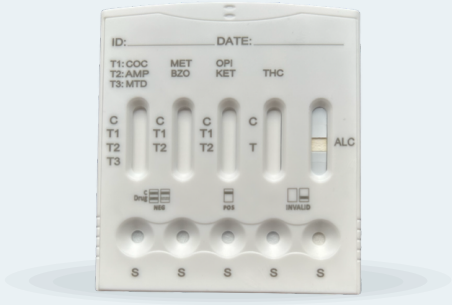


8 + 1 Kassette

8 Drogen + Alkohol

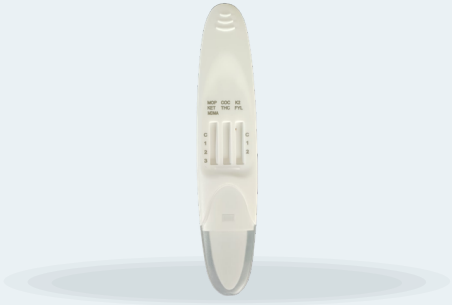

9er-Stift

9 Drogen-Substanzen

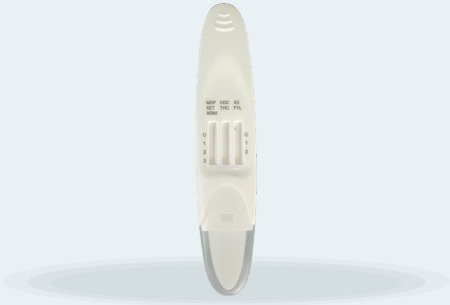

12er-Stift

bis zu 12 Drogen-Substanzen



15er-Becher

15 Drogen-Substanzen

Die folgenden Seiten erläutern jede Form mit ihren Katalogangaben und Originalabbildungen.

Alkohol-Stift | Fit2Drive





Was macht der Test?

Der Stift prüft Alkohol in Speichel. Die Produktliste nennt Ausführungen mit Anzeigen von 0,00 bis 0,30 %. Die Prozentangaben des Speicheltests sind nicht mit einem Atem- oder Blutalkoholwert gleichzusetzen.

So funktioniert es

Kappe abnehmen, Sammelspitze an Zahnfleisch und Zunge führen und unter die Zunge halten. Die Alkoholanzeige laut Katalog nach 3 bis 5 Minuten lesen. Für genaue Schritte gilt immer die Packungsanleitung.

Ein negatives Ergebnis bestätigt keine Fahrtüchtigkeit. In Deutschland gilt grundsätzlich die 0,5-‰-Grenze; schon ab 0,3 ‰ können alkoholbedingte Ausfallerscheinungen strafrechtliche Folgen haben. Bußgeld, Fahrverbot oder Entzug der Fahrerlaubnis sind möglich. Nach einem Unfall kann die Kfz-Haftpflichtversicherung unter bestimmten Voraussetzungen Regress verlangen.

ARTIKEL: #CRP-D062-8003-NM | auch als 3er-Pack gelistet

THC-Kassette | 3,5 ng/ml



THC = Cannabis-Wirkstoff

Der Test sucht nach THC im Speichel. Ein Ergebnis sagt weder, wie stark jemand beeinträchtigt ist, noch ob ein gesetzlicher Blutgrenzwert eingehalten wird.

Was bedeutet 3,5 ng/ml?

Das ist der im Katalog genannte Grenzwert dieser Speichel-Kassette. Die gleiche Zahl bei einer gesetzlichen Blutserum-Grenze ist ein anderer Messwert in einer anderen Probe. Aus Speichel lässt sich kein Blutwert errechnen.

Einfache Anwendung


Mit dem Schwamm Speichel sammeln, im Röhrchen ausdrücken und drei Tropfen in die Kassette geben. Ergebnis im angegebenen Zeitfenster von 3 bis 10 Minuten ablesen. Die genaue Packungsanleitung hat Vorrang.

ARTIKEL: #CRP-D022-P8002-NM

Deutschland: Der gesetzliche THC-Grenzwert beträgt 3,5 ng/ml im Blutserum. Der Cut-off der Speichelkassette ist damit nicht vergleichbar. Eine feste Umrechnung mit Faktor 16,7 ist nicht belegt: 3,5 × 16,7 = 58,45 ng/ml ist nur eine Rechnung, kein gültiger Speichelgrenzwert. Ab 3,5 ng/ml sieht der Bußgeldkatalog beim ersten Verstoß 500 € und einen Monat Fahrverbot vor; bei Wiederholung mehr. Eine MPU und versicherungsrechtliche Folgen hängen vom Einzelfall ab.

SPEICHEL • MEHRFACHTEST

Fit2Drive 9 | Kassette 8 + 1

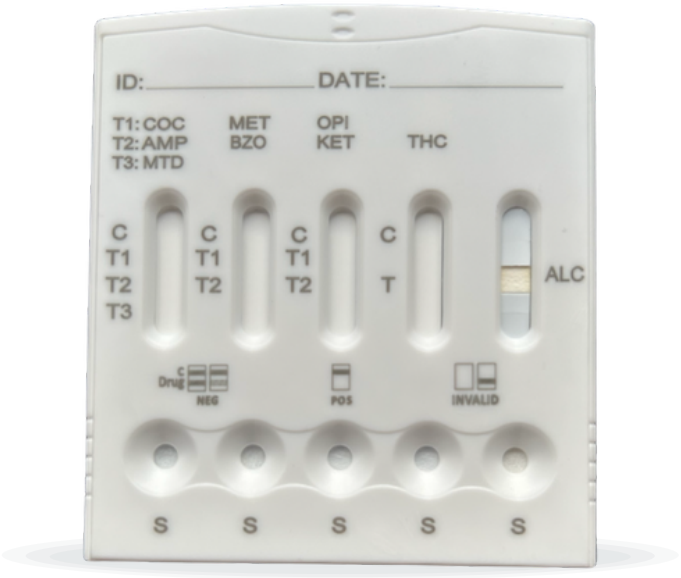

COC
Kokain

AMP
Amphetamin

MTD
Methadon

OP
Opiate

MET
Methamphetamin

BZO
Benzodiazepine

KET
Ketamin

THC
Cannabis

ALC
Alkohol


Für wen?

Eine Kassette für mehrere Stoffgruppen in einer Speichelprobe. Der Katalog stellt sie als Fit2Drive-Variante dar. Das Ergebnis ist ein Screening, keine Aussage über Fahrtüchtigkeit.

ARTIKEL: #CRP-D000-8095-A-NM

OP ist die Abkürzung in der 2026er Produktliste. Die genaue Zielsubstanz und alle Grenzwerte stehen in der Produktspezifikation.

9er-Stift | zwei Varianten für die Industrie

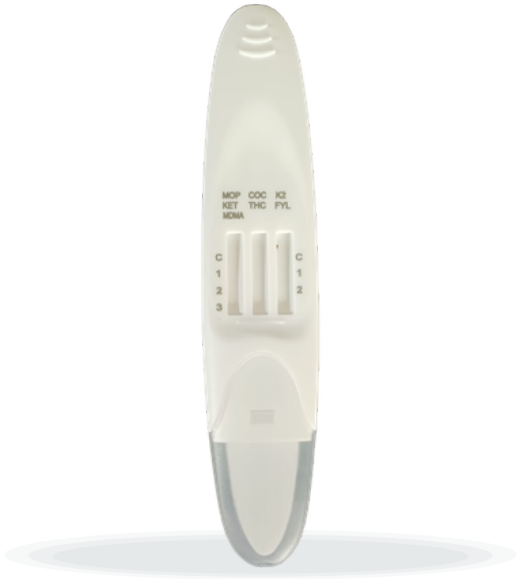

Variante Office

MOP • KET • MDMA • COC • AMP • PCP • MET • THC • LSD. Der Stift prüft neun im Katalog aufgeführte Ziele gleichzeitig.

Variante Production

K2 • MTD • TML • MOP • BZO • THC • FYL • BAR • OXY. Ein anderes Set von neun Zielen für die passende Richtlinie.

Wie benutzt man den Stift?

Kappe abnehmen, die Sammelspitze etwa 60 Sekunden an Zahnfleisch und Zunge führen und unter die Zunge halten. Das Ergebnis wird nach der jeweiligen Anleitung abgelesen; der Katalog nennt frühestens etwa 3 Minuten.

ARTIKEL: Office: #CRP-D000-8093-D-OF-NM

ARTIKEL: Production: #CRP-D000-8093-D-PR-NM

1 Substanz oder bis zu 12 Substanzen in einem Test



Mehrfach-Stift: 2 bis 12 Substanzen

Der Katalog beschreibt frei zusammengestellte Speichel-Stifte mit 2 bis höchstens 12 Zielen. Er enthält keine einzige feste „12er“-Zusammensetzung. Wählen Sie die Stoffgruppen vor Bestellung und lassen Sie Panel, Grenzwerte und Artikelnummer schriftlich bestätigen.

AUCH ALS EINZEL-STIFTE GELISTET

COC
Kokain

20 ng/ml

KET
Ketamin

50 ng/ml

MDMA
Ecstasy

50 ng/ml

THC
Cannabis

12 ng/ml

LSD
LSD

10 ng/ml

Dies sind Speichel-Grenzwerte der Produktliste. Der THC-Einzelstift (12 ng/ml) ist eine andere Variante als die 3,5-ng/ml-Kassette.

Becher | 15 Substanzen in einem Test





15 SUBSTANZEN IN EINEM TEST-PRODUKT

MOP Opiate	**MET** Methamphetamin	**OXY** Oxycodon
COC Kokain	**AMP** Amphetamin	**LSD** LSD
BZO Benzodiazepine	**MDMA** Ecstasy	**FYL** Fentanyl
KET Ketamin	**ZOP** Zopiclon	**MTD** Methadon
BAR Barbiturate	**TML** Tramadol	**THC** Cannabis

15 Test-Streifen in einem Test-Produkt (CUP)

Mit dem Sammelschwamm Speichel aufnehmen und in den Becher geben. Deckel schließen und gemäß Anleitung mischen. Im Katalog werden 3 bis 10 Minuten zum Ablesen genannt. Jeder Teststreifen ist einzeln zu beurteilen.

ARTIKEL: #CRP-D000-8157-C-F2D-NM

Der Multi-Cup prüft 15 Drogensubstanzen. Ein positives Screening-Ergebnis allein führt nicht automatisch zum Fahrverbot; es ist fachgerecht zu bestätigen. Mögliche Fahrverbote, Bußgelder und Folgen für die Kfz-Haftpflicht hängen vom bestätigten Befund und den Umständen ab.

Weitere Testprodukte und der Ablauf der Testung

Fit2Work Office | 12 Ziele

Beispielkonfiguration mit MOP, MET, COC, AMP, PCP, LSD, MDMA, KET, MEP, MDPV, alpha-PVP und THC.

Fit2Work Production | 12 Ziele

Beispielkonfiguration mit MOP, OXY, MDMA, BZO, FYL, CFYL, K2, ZOP, MTD, BAR, TML und THC.

IN FÜNF EINFACHEN SCHRITTEN

1

Öffnen

Versiegelung und Haltbarkeit prüfen.

2

Sammeln

Mit der weichen Spitze Speichel aufnehmen.

3

Einsetzen

Sammelteil nach Anleitung in den Becher geben.

4

Warten

Zeitfenster der Packung einhalten.

5

Lesen

Kontroll- und Testlinien je Feld prüfen.


Office: #CRP-D000-8127-C-F2WO-NM • Production: #CRP-D000-8127-C-F2WP-NM

Alle Becher-Konfigurationen und Grenzwerte vor Einsatz mit der aktuellen Produktspezifikation abgleichen.

Was bedeutet das Ergebnis?

UNAUFFÄLLIG

Die Kontrolle funktioniert. Der Stoff wurde bei diesem Grenzwert nicht nachgewiesen. Das beweist keine Abstinenz oder Eignung.

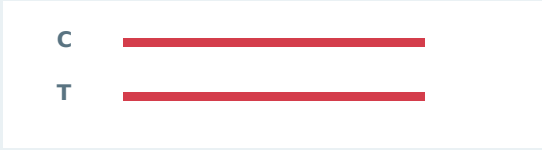

AUFFÄLLIG

Das Screening zeigt einen vorläufigen Hinweis. Vor einer folgenreichen Entscheidung fachgerecht bestätigen lassen.



UNGÜLTIG

Die Kontrolle fehlt oder die Anzeige ist nicht auswertbar. Mit einem neuen Test nach Anleitung wiederholen.



C = Kontrolllinie; T = Testlinie. Schema für Drogenstreifen – Alkohol-Anzeigen können anders aussehen.

Warum sind Grenzwerte wichtig?

Ein Grenzwert legt fest, ab welcher Menge ein Test reagieren soll. Speichel und Urin sind unterschiedliche Proben. Auch gleiche Zahlen in Speichel und Blut können nicht direkt verglichen werden.

Bei ärztlich verordneten Medikamenten: Ergebnis und Medikation vertraulich fachlich prüfen.

Die Anzeigeform kann je Produkt variieren. Dieses Schaubild ersetzt keine Anleitung des konkreten Tests.



EIGENER PRODUKTBEREICH

Drogenschnelltests aus Urin

Mehrfach-Panels mit eigenem Probenweg und eigener Produktspezifikation.

Hintergrundszene illustrativ; sie zeigt keine konkrete CRP-Produktvariante.

Urin-Panel | 9 Substanzen

Das bereitgestellte Produktlabel zeigt einen konkreten CRP-Urin-Mehrfachtest.



NEUN DROGEN-SUBSTANZEN

Eine Urinprobe, neun Testfelder:

OPI Opiate	**PCP** Phencyclidin	**COC** Kokain
BAR Barbiturate	**BZO** Benzodiazepine	**AMP** Amphetamin
MTD Methadon	**TCA** Trizyklische Antidepressiva	**THC** Cannabis

ARTIKEL: CRP-D000-1094B-NM

WEITERE URIN-PANELS

12er- und 20er-Varianten sind im CRP-Produktkontext erwähnt. Für diese Varianten bitte die aktuelle Stoffliste, Grenzwerte, Ablesezeit und Produktbilder separat anfordern.

NÄCHSTER SCHRITT

Kontakt und Auswahlhilfe

So bestellen Sie das richtige Produkt

Nennen Sie die Probe (Speichel oder Urin), die gewünschten Stoffgruppen, die Anzahl der Ziele und den Einsatzbereich. Fordern Sie für die konkrete Variante die aktuelle Anleitung, Grenzwerte und Artikelnummer an.

CRP FUSION

Telefon Rumänien: +40 729 642 999

Telefon International: +40 748 359 283

Telefon Deutschland: +49 174 175 4896

contact@crpfusion.ro

www.crpfusion.ro

9 Alexandru Odobescu Str., 500271 Brașov
Rumänien

QUELLEN UND REDAKTIONELLE HINWEISE

Speichel-Produktnamen, Codes, Panels und Bilder: „CS RO_CATALOG CRP Fusion_2026.pdf“, Seiten 1–9. Urinprodukt 9B: das ergänzend bereitgestellte Produktlabel. Weitere Urin-Panels benötigen aktuelle Datenblätter.

Allgemeine Einordnung von Schnelltests: FDA, „Drugs of Abuse Home Use Test“; MedlinePlus, „Drug Testing“. Aussagen zum deutschen THC-Blutserumwert: § 24a StVG; ein Speichelwert ist damit nicht gleichzusetzen.

Rechtliche Hinweise: § 24a StVG, § 316 StGB, Bußgeldkatalog Nr. 241/242, § 13a FeV, § 5 KfzPflVV.

Schnelltests sind Screeningverfahren. Die Herstelleranleitung des jeweiligen Artikels ist maßgeblich.

Stand: September 2026 • Bildmaterial aus dem bereitgestellten Katalog; Fotoszenen illustrativ.

Kundenspezifische Labels für den ALC-Selbsttest

Die Labels können auch auf Kartons und Umverpackungen genutzt werden.



DESIGN-BEISPIELE AUS VERSCHIEDENEN PROJEKTEN

CRP Fusion erstellt und produziert die kundenspezifischen Labels in eigener Regie und liefert das gewünschte Label als Kunststoff-Pouch oder in einer Box. Die Anzahl der Tests pro Box wird durch den Kunden festgelegt.

LABELGRÖSSE: 154,5 × 47,5 mm



Echipa




LiT



Oscar Gas



TotalEnergies

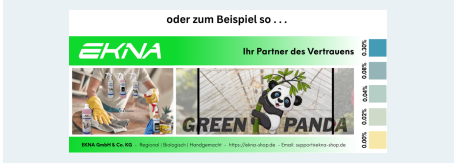

EKNA



Oktoberfest

ALC-SELBSTTEST



Speichel-Stift

Ergebnis: 3–5 Minuten*

* Gemäß Produktkatalog. Die Anleitung des konkreten Tests gilt. Fotoszene illustrativ.

Anlage A | Speichel: verfügbare Substanzen

33 Stoffe/Stoffgruppen und Alkohol · Nachweisgrenzen gemäß bereitgestellter Übersicht

NR.	SUBSTANZ / STOFFGRUPPE	CUT-OFF (ng/mL)
01	Amfetamin (AMP)	**50**
02	Metamfetamin (MET)	**50**
03	Cannabis (THC)	**50 / 40 / 25 / 20 / 12 / 3,5**
04	Phencyclidin (PCP)	**10**
05	Kokain (COC)	**20**
06	Opiate (MOP/OPI)	**40 / 25**
07	Methadon (MTD)	**30**
08	MDMA	**50**
09	Oxycodon (OXY)	**50 / 20**
10	Cotinin (COT)	**20**
11	Benzodiazepine (BZO)	**50 / 30 / 20 / 10**
12	Synthetische Cannabinoide (K2)	**25**
13	Ketamin (KET)	**50**
14	Barbiturate (BAR)	**50**
15	Buprenorphin (BUP)	**10 / 5**
16	Tramadol (TML)	**30**
17	6-MAM (Heroinmetabolit)	**10**
18	Fentanyl (FYL)	**50 / 20 / 10**
19	Carfentanil (CFYL)	**50**
20	MDPV	**300**
21	Alpha-PVP	**300**
22	LSD	**10**
23	Propoxyphen (PPX)	**50**
24	Methaqualon (MQL)	**300**
25	Carisoprodol (CAR)	**300**
26	EDDP	**50**
27	AB-PINACA (ABP/K3)	**10**
28	UR-144 (K4)	**25**
29	Zopiclon (ZOP)	**50**
30	Gabapentin (GAB)	**2.000**
31	Pregabalin (PGB)	**500**
32	Kratom (KRA)	**300**
33	Mephedron (MEP)	**100**

ALKOHOL (ALC)	**0,02 / 0,04 / 0,08 / 0,30 % (Alkohol; nicht ng/mL)**

Die Cut-offs sind Varianten aus der Vorlage; Verfügbarkeit und Grenzwert des konkreten Produkts bitte vor Bestellung bestätigen.

Quelle: Substante_Dispozitive_Saliva_CRP Fusion_02.2026_Social Med_.pdf

Anlage B | Urin: verfügbare Substanzen

Einträge 01–34 · Nachweisgrenzen gemäß bereitgestellter Übersicht

NR.	SUBSTANZ / STOFFGRUPPE	CUT-OFF (ng/mL)
01	Paracetamol (ACE)	**5.000**
02	Amfetamine (AMP)	**1.000 / 500 / 300**
03	Barbiturate (BAR)	**300 / 200**
04	Benzodiazepine (BZO)	**500 / 300 / 200 / 100**
05	Buprenorphin (BUP)	**10 / 5**
06	Kokain (COC)	**300 / 200 / 150 / 100**
07	Cannabis (THC)	**600 / 300 / 200 / 150 / 50 / 30 / 25 / 20**
08	Methadon (MTD)	**300 / 200**
09	Metamfetamin (MET)	**1.000 / 500 / 300**
10	MDMA	**300 / 500 / 1.000**
11	Morphin/Opiate (MOP/OPI)	**300 / 200 / 100**
12	Methaqualon (MQL)	**300**
13	Meperidin (MPRD)	**100**
14	Opiate (OPI)	**2.000 / 1.000**
15	Phencyclidin (PCP)	**50 / 25**
16	Propoxyphen (PPX)	**300**
17	Trizyklische Antidepressiva (TCA)	**1.000 / 500 / 300**

NR.	SUBSTANZ / STOFFGRUPPE	CUT-OFF (ng/mL)
18	Tramadol (TML)	**100 / 200 / 300 / 500**
19	Ketamin (KET)	**1.000 / 500 / 300 / 100**
20	Oxycodon (OXY)	**300 / 100**
21	Cotinin (COT)	**500 / 300 / 200 / 100 / 50 / 10**
22	EDDP	**300 / 100**
23	Fentanyl (FYL)	**200 / 100 / 20 / 10**
24	Synthetische Cannabinoide (K2)	**50 / 30 / 25**
25	6-MAM	**10**
26	MDA	**500**
27	Ethylglucuronid (ETG)	**1.000 / 500 / 300**
28	Clonazepam (CLO)	**400 / 150**
29	LSD	**10 / 20 / 50**
30	Methylphenidat (MPD)	**300 / 150**
31	Ritalinsäure (MPD)	**1.000**
32	Zolpidem (ZOL)	**50**
33	Mephedron (MEP)	**500 / 100**
34	MDPV	**1.000 / 500 / 300**

Die Cut-offs sind Varianten aus der Vorlage; Verfügbarkeit und Grenzwert des konkreten Produkts bitte vor Bestellung bestätigen.

Quelle: Substante_Dispozitive_Urina_CRP Fusion_02.2026_Social Med_.pdf

Anlage B | Urin: verfügbare Substanzen

Einträge 35–67 · Nachweisgrenzen gemäß bereitgestellter Übersicht

NR.	SUBSTANZ / STOFFGRUPPE	CUT-OFF (ng/mL)
35	Diazepam (DIA)	**300 / 200**
36	Zopiclon (ZOP)	**50**
37	Methcathinon (MCAT)	**500**
38	7-Aminoclonazepam (7-ACL)	**300 / 200 / 100**
39	Carfentanil (CFYL)	**500 / 250**
40	Cannabinol (CNB)	**500**
41	Koffein (CAF)	**1.000**
42	Cathin (CAT)	**150**
43	Tropicamid (TRO)	**350**
44	Alprazolam (ALP)	**100**
45	Pregabalin (PGB)	**50.000 / 500**
46	Gabapentin (GAB)	**2.000**
47	Zaleplon (ZAL)	**100**
48	Carisoprodol (CAR)	**2.000 / 1.000**
49	AB-PINACA (ABP)	**10**
50	Quetiazepam (QTP)	**1.000**
51	Fluoxetin (FLX)	**500**

NR.	SUBSTANZ / STOFFGRUPPE	CUT-OFF (ng/mL)
52	UR-144	**25**
53	Kratom (KRA)	**300**
54	Tilidin (TLD)	**50**
55	Trazodon (TZD)	**200**
56	Alpha-PVP	**2.000 / 1.000 / 500 / 300**
57	Mescalin (MES)	**100 / 300**
58	Papaverin (PAP)	**500**
59	Citalopram (CIT)	**500**
60	Fluoketamin (FKET)	**1.000**
61	Olanzapin (OZP)	**1.000**
62	Risperidon (RPD)	**150**
63	Tapentadol (TAP)	**1.000**
64	DMT (NND)	**1.000**
65	Scopolamin (SCOP)	**500**
66	Mirtazapin-Metabolit (MTZ)	**500**
67	Alkohol (ALC)	**0,02 %**

Cut-offs gemäß Vorlage; Alkohol in %, alle anderen Angaben in ng/mL. Produktvariante und Grenzwert bitte bestätigen.

Quelle: Substante_Dispozitive_Urina_CRP Fusion_02.2026_Social Med_.pdf

Preisliste | Speichel, Urin & Drink-Check

Preisliste 2026

Alle aufgeführten Produkte · EUR netto sowie RON netto / brutto

Stand der vorgelegten Preisliste: 28.09.2026



PRODUKT / KATALOGNUMMER	EUR N.	RON N.	RON B.
SPEICHEL | EINZELTESTS			
ALC-Stift mit Box CRP-D062-8003-NM	2,66	13,95	16,88
ALC-Stift ohne Box CRP-D062-8003-NM	2,22	11,68	14,13
THC-Kassette CRP-D022-P8002-NM	4,33	22,71	27,48
THC-Stift CRP-D022-8003-NM	4,66	24,46	29,60
COC-Stift CRP-D006-8003-NM	4,66	24,46	29,60
KET-Stift CRP-D011-8003-NM	5,99	31,47	38,08
LSD-Stift TZKM-D035-8003-NM	6,33	33,22	40,20
PCP-Stift TZKM-D019-8002-NM	4,66	24,46	29,60
MDMA-Stift CRP-D012-8003-NM	4,33	22,71	27,48
SPEICHEL | MEHRFACHTESTS			
8+1 Kassette CRP-D000-8085-A-NM	7,75	40,71	49,25
12er-Stift Fit2Work CRP-D000-8123-D-NM	8,62	45,26	54,77
12er-Becher Production CRP-D000-8127PC-NM	8,50	44,61	53,98
12er-Becher Office CRP-D000-8127OC-NM	8,60	45,15	54,63
15er-Becher Fit2Drive PRO CRP-D000-8157DC-NM	8,09	42,45	51,36

PRODUKT / KATALOGNUMMER	EUR N.	RON N.	RON B.
URIN | PANELS UND BECHER			
5er-Panel CRP-D000-1054-NM	3,52	18,51	22,39
6er-Panel CRP-D000-1064-NM	3,91	20,52	24,83
7er-Panel CRP-D000-1074-NM	4,53	23,78	28,78
8er-Panel CRP-D000-1084-NM	4,83	25,33	30,65
9er-Panel CRP-D000-1094-NM	5,15	27,04	32,72
10er-Panel CRP-D000-1104-NM	5,48	28,75	34,78
12er-Panel CRP-D000-1124-NM	7,87	41,32	50,00
20er-Panel CRP-D000-1204-NM	13,40	70,34	85,11
10er-Becher Clinics CRP-D000-1107-NM	7,13	37,44	45,30
DRINK-CHECK			
Wristband 3×3 HD-000-D036-NM	11,74	61,65	74,59

Preisangaben je Produkt gemäß Vorlage.

EUR N. = EUR netto · RON N. = RON netto

RON B. = RON brutto; Produktfoto illustrativ.

FAQ | Produkte und Testformen

WAS BEDEUTEN DIE PRODUKTNAMEN?

Fit2Drive bezeichnet Produkte zur Selbstorientierung vor einer geplanten Fahrt. Fit2Work umfasst Konfigurationen für Testprogramme am Arbeitsplatz. Der Name einer Produktlinie ersetzt weder die genaue Stoffliste noch die Anleitung der gewählten Variante.



DIE TESTFORMEN IM ÜBERBLICK

FORMAT	WAS IST DAS?	BEISPIEL IN DER BROSCHÜRE
Stift	Test mit Sammelspitze für Speichel; prüft eine oder mehrere Substanzen.	ALC, THC, Fit2Work
Kassette	Speichel wird gesammelt und anschließend in die Testöffnung gegeben.	THC 3,5 ng/mL; Fit2Drive 8+1
Becher (CUP)	Probenaufnahme und Testung erfolgen in einem Bechersystem.	Fit2Drive PRO, 15 Substanzen
Panel	Die konkrete Auswahl der Stoffe oder Stoffgruppen in einem Test.	Urin-Panel mit 9 Substanzen

8+1 = acht Stoffgruppen plus ein separates Alkohol-Anzeigefeld. Die genaue Zusammensetzung steht auf dem Produkt.

FAQ | Ergebnisse, Cut-offs und Bestätigung

Was ist ein Screeningtest?

Eine erste, qualitative Prüfung. Das Ergebnis zeigt, ob der Test nach den für dieses Produkt festgelegten Kriterien reagiert.

Was bedeutet Cut-off oder Grenzwert?

Die Konzentration, ab der der Test reagieren soll. 3,5 ng/mL beziehen sich auf die angegebene Probe und Substanz; es ist kein Blutwert.



WIE LIEST MAN EINEN TEST MIT C- UND T-LINIE?

UNAUFFÄLLIG



C + T

Der Stoff wurde bei diesem Testgrenzwert nicht nachgewiesen.


VORLÄUFIG AUFFÄLLIG



C ohne T

Vor wichtigen Entscheidungen fachgerecht bestätigen lassen.

UNGÜLTIG



Ohne C

Mit einem neuen Test nach Anleitung wiederholen.

Nachweiszeiten variieren. Speichel oder Urin belegen allein weder den Konsumzeitpunkt noch die Fahrtüchtigkeit.

Die Anleitung des jeweiligen Tests ist maßgeblich. Das C/T-Schema gilt für Drogenstreifen; Alkoholanzeigen können anders aussehen.

Allgemeine Quelle: FDA, „Drugs of Abuse Home Use Test" (fda.gov/medical-devices/drugs-abuse-tests/drugs-abuse-home-use-test).

FAQ | PEDT-Services und Testauswahl

Was ist PEDT?

Pre-Employment Drug Testing: organisierte Drogentests vor einer Einstellung gemäß Kundenauftrag und geltendem Verfahren.

Was ist Background Screening?

Die Prüfung einstellungsrelevanter Angaben. Dieser eigenständige Service kann mit PEDT koordiniert werden.



ABLAUF EINES PEDT-AUFTRAGS

01 Anfrage
Land, Ort und Panel

→

02 Termin
Testzentrum und Person

→

03 Probenahme
Probe und Identität

→

04 Screening
Vorläufiges Ergebnis

→

05 Bericht
Gemäß vereinbartem Ablauf

Was sind Zufallstests?

Testungen nach einer zuvor festgelegten Unternehmensregel, mit bestimmten Intervallen oder Auswahlverfahren.

Was ist bei der Bestellung anzugeben?

Probe: Speichel oder Urin; Stoffe, Grenzwerte, Testzahl und Einsatzort. Fordern Sie das Datenblatt der genauen Variante an.

Kontakt: contact@crpfusion.ro | Rumänien: +40 729 642 999 | Deutschland: +49 174 175 4896 | www.crpfusion.ro